


Qualité analytique: service bactériologie

La qualité analytique de la bactériologie conventionnelle de l'Institut Dr. Viollier (IDV) est régulièrement vérifiée par des contrôles externes provenant de deux centres de contrôle de qualité.

La bactériologie conventionnelle de l'Institut Dr. Viollier se distingue par une qualité au-dessus de la moyenne.


Contrôle de qualité anglais

UKNEQAS, bactériologie générale

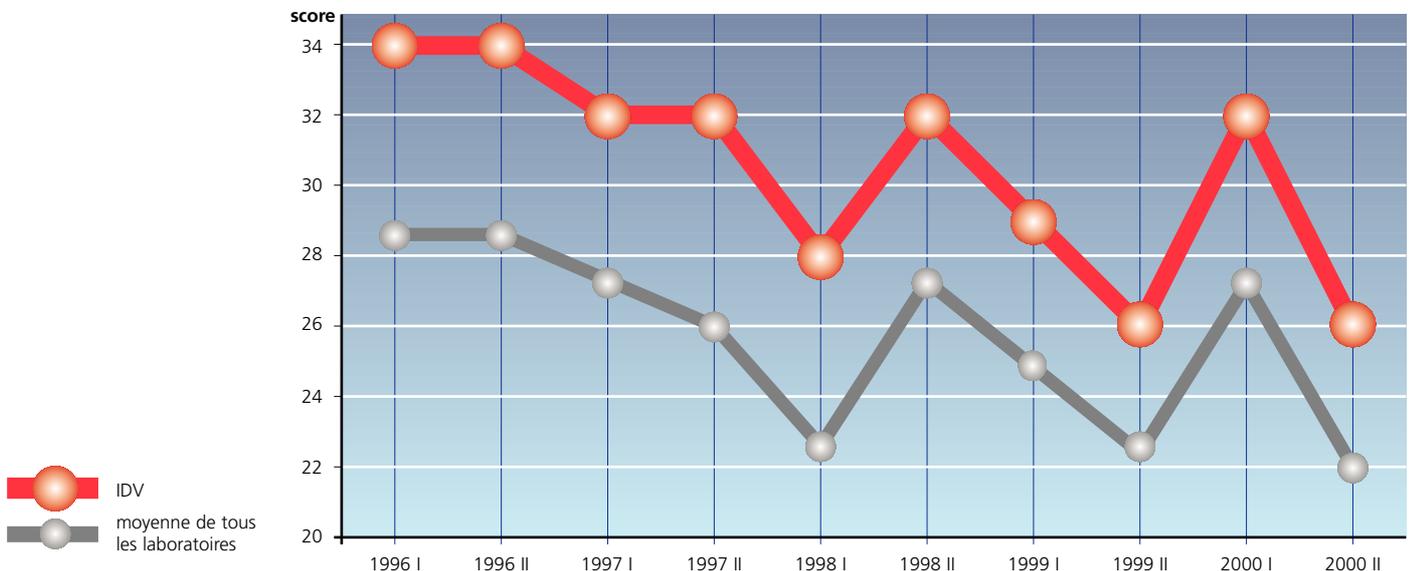

Contrôle de qualité suisse

IMMZ, bactériologie générale

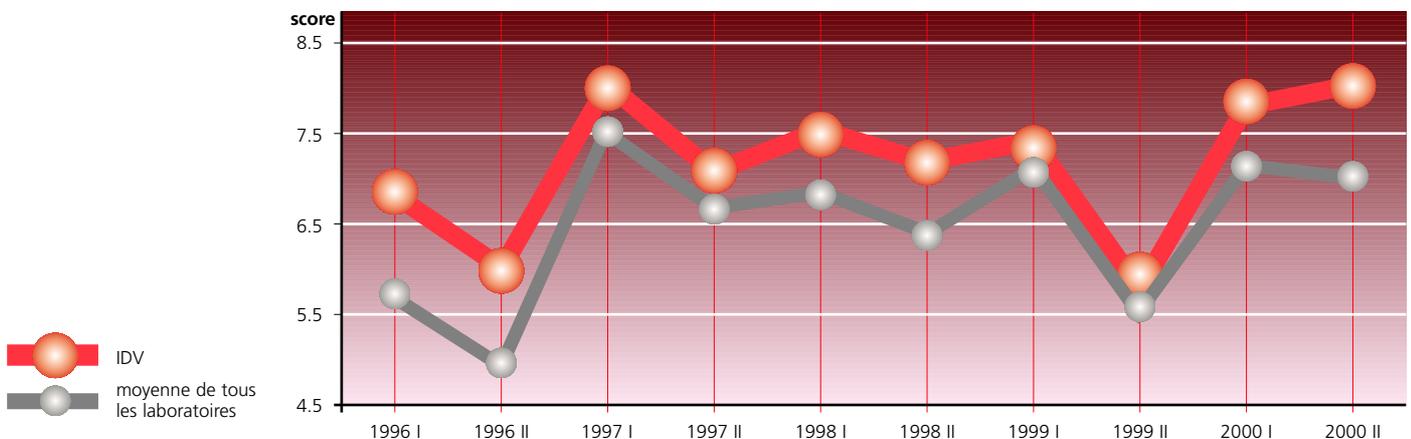

Information

Evelyne Boulaz, adjointe au responsable du service bactériologie
Dr med. Adrian Keller, médecin spécialiste FAMH microbiologie et immunologie, VioLab Biel/Bienne
PD Dr med. Lukas Matter, responsable du service immunologie